

Naturherz
An der Helle 11 A

59505 Bad Sassendorf

ZERTIFIKAT / CERTIFICATE

HAUTVERTRÄGLICHKEIT/ SKIN COMPATIBILITY
DPV 2.0_1801-035 11.02.2018

Das kosmetische Produkt
The cosmetic product

**Reinigungsgel
119-17-1-9P**

wurde von mir unter fachkundlicher Aufsicht einem Patchtest unterzogen.
Bei dieser Untersuchung handelt es sich um eine standardisierte dermatologische Prüfung zur Feststellung der Hautverträglichkeit. Die Untersuchung wurde gemäß den Empfehlungen der COLIPA- Expertengruppe in vivo an 50 Testpersonen durchgeführt.
Die Einzelheiten der Versuchsdurchführung sind in einem separaten Protokoll dokumentiert.
Diese Untersuchung ergab keine Hinweise auf potentiell hautreizende Wirkung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Die Hautverträglichkeit dieses Produkt bewerte ich daher unter Berücksichtigung der Anwendungsbedingungen als:

has been tested under expert guidance for its dermal compatibility in a patch test .
The patch test is a standardised dermatological examination to check the compatibility of preparations to be used on the human skin. The examination was carried out according to the recommendations of the expert group of COLIPA in vivo at 50 persons. The details of the examination are recorded in a separate test protocol.

The examination did not show evidence of possible incompatibilities of the product to the human skin considering the conditions of use. I therefore assess the skin compatibility of the product under the intended conditions of use as:

**sehr gut
very good**

Dr. rer. nat. Wolfgang J. Beckermann
Diplom-Biologe / Biologist, Ph.D.

Naturherz
An der Helle 11 A

59505 Bad Sassendorf

ZERTIFIKAT / CERTIFICATE

HAUTVERTRÄGLICHKEIT/ SKIN COMPATIBILITY

DPV 2.0_1801-034 11.02.2018

Das kosmetische Produkt
The cosmetic product

**Augencreme
119-17-3-10P**


wurde von mir unter fachkundlicher Aufsicht einem Patchtest unterzogen.
Bei dieser Untersuchung handelt es sich um eine standardisierte dermatologische Prüfung zur Feststellung der Hautverträglichkeit. Die Untersuchung wurde gemäß den Empfehlungen der COLIPA- Expertengruppe in vivo an 50 Testpersonen durchgeführt.
Die Einzelheiten der Versuchsdurchführung sind in einem separaten Protokoll dokumentiert.
Diese Untersuchung ergab keine Hinweise auf potentiell hautreizende Wirkung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Die Hautverträglichkeit dieses Produkt bewerte ich daher unter Berücksichtigung der Anwendungsbedingungen als:

has been tested under expert guidance for its dermal compatibility in a patch test .
The patch test is a standardised dermatological examination to check the compatibility of preparations to be used on the human skin. The examination was carried out according to the recommendations of the expert group of COLIPA in vivo at 50 persons. The details of the examination are recorded in a separate test protocol.

The examination did not show evidence of possible incompatibilities of the product to the human skin considering the conditions of use. I therefore assess the skin compatibility of the product under the intended conditions of use as:

**sehr gut
very good**

Dr. rer. nat. Wolfgang J. Beckermann
Diplom-Biologe / Biologist, Ph.D.

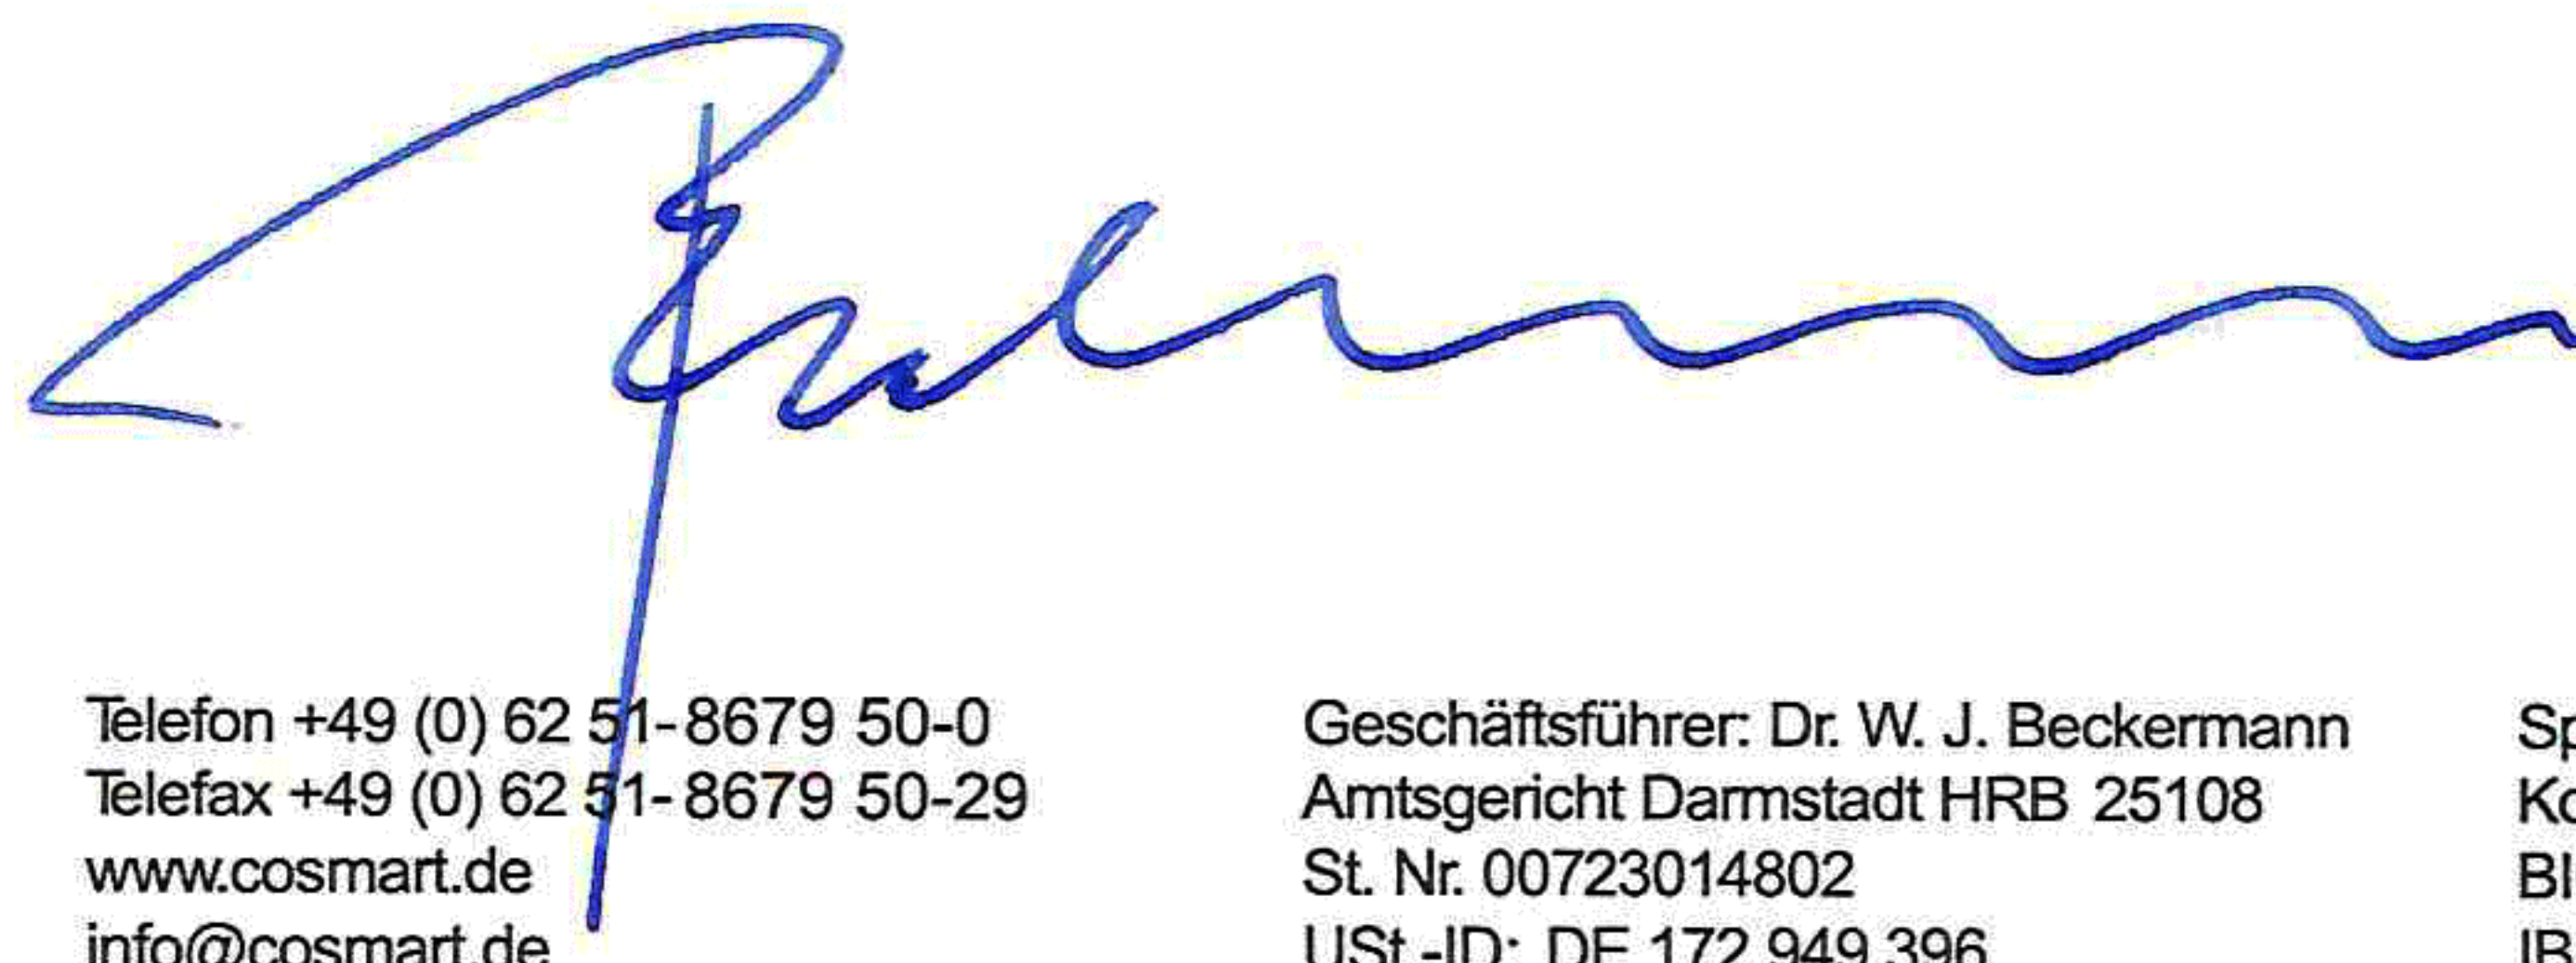

Naturherz
An der Helle 11 A

59505 Bad Sassendorf

ZERTIFIKAT / CERTIFICATE
HAUTVERTRÄGLICHKEIT/ SKIN COMPATIBILITY
DPV 2.0_1801-033 11.02.2018

Das kosmetische Produkt
The cosmetic product

Gesichtspflegecreme 119-17-2-13P

wurde von mir unter fachkundlicher Aufsicht einem Patchtest unterzogen.
Bei dieser Untersuchung handelt es sich um eine standardisierte dermatologische Prüfung zur Feststellung der Hautverträglichkeit. Die Untersuchung wurde gemäß den Empfehlungen der COLIPA- Expertengruppe in vivo an 50 Testpersonen durchgeführt.
Die Einzelheiten der Versuchsdurchführung sind in einem separaten Protokoll dokumentiert.
Diese Untersuchung ergab keine Hinweise auf potentiell hautreizende Wirkung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Die Hautverträglichkeit dieses Produkt bewerte ich daher unter Berücksichtigung der Anwendungsbedingungen als:

has been tested under expert guidance for its dermal compatibility in a patch test .
The patch test is a standardised dermatological examination to check the compatibility of preparations to be used on the human skin. The examination was carried out according to the recommendations of the expert group of COLIPA in vivo at 50 persons. The details of the examination are recorded in a separate test protocol.

The examination did not show evidence of possible incompatibilities of the product to the human skin considering the conditions of use. I therefore assess the skin compatibility of the product under the intended conditions of use as:

**sehr gut
very good**

Dr. rer. nat. Wolfgang J. Beckermann
Diplom-Biologe / Biologist, Ph.D.

